



Der Wondfo One Step Strept A Swab Test est un appareil Lateral-Flow-Immunoassay pour les diagnostics rapides. Il est utilisé pour le diagnostic de l'infection à streptocoque de groupe A (Streptococcus pyogenes). Le test est effectué sur un échantillon de 100 µl de mucus ou de salive prélevé à l'aide d'un applicateur buccal. Le résultat est obtenu dans les 5 minutes.

WIE FUNKTIONNIERT DER TEST ?

Le streptocoque de groupe A (Streptococcus pyogenes) est la principale cause de l'angine streptococcique. Les symptômes courants de cette infection comprennent la gorge rouge et enflammée, la douleur à la déglutition, les ganglions lymphatiques enflés, la fièvre, les taches blanches ou jaunâtres sur la gorge et les amygdales. Le test Strept A Swab Test est un test rapide et facile à utiliser qui permet de détecter la présence de streptocoque de groupe A dans le mucus ou la salive en 5 minutes. Le test est effectué sur un échantillon de 100 µl de mucus ou de salive prélevé à l'aide d'un applicateur buccal. Le résultat est obtenu dans les 5 minutes. Le test est effectué dans la zone de test (T) de la bandelette et la ligne de contrôle (C) est toujours présente. Si la ligne de test (T) est présente, le résultat est positif (P) et indique la présence de streptocoque de groupe A. Si la ligne de test (T) est absente, le résultat est négatif (N) et indique l'absence de streptocoque de groupe A. Le test est effectué dans la zone de test (T) de la bandelette et la ligne de contrôle (C) est toujours présente. Si la ligne de test (T) est présente, le résultat est positif (P) et indique la présence de streptocoque de groupe A. Si la ligne de test (T) est absente, le résultat est négatif (N) et indique l'absence de streptocoque de groupe A.

INHALT DES TESTKITS

- 1. Boîte de test kit avec 4 tests.
- 1. Boîte de test kit avec 4 tests.
- 1. Boîte de test kit avec 4 tests.
- 1. Boîte de test kit avec 4 tests.
- 1. Boîte de test kit avec 4 tests.

UTILISATION

1. Retirez le contenu du test kit de son emballage.
2. Appliquez 100 µl de mucus ou de salive sur le tampon.
3. Attendez 5 minutes et lisez les résultats.
4. Interprétez les résultats.

RESULTATS

Le résultat positif est obtenu dans les 5 minutes. Le résultat négatif est obtenu dans les 5 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.


STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

1. Retirez le contenu du test kit de son emballage.
2. Appliquez 100 µl de mucus ou de salive sur le tampon.
3. Attendez 5 minutes et lisez les résultats.
4. Interprétez les résultats.

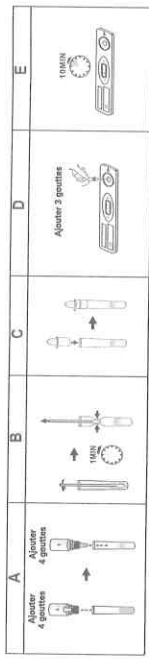

COMMENT LIRE LES RESULTATS ?

Le résultat positif est obtenu dans les 5 minutes. Le résultat négatif est obtenu dans les 5 minutes. Le test est effectué dans la zone de test (T) de la bandelette et la ligne de contrôle (C) est toujours présente. Si la ligne de test (T) est présente, le résultat est positif (P) et indique la présence de streptocoque de groupe A. Si la ligne de test (T) est absente, le résultat est négatif (N) et indique l'absence de streptocoque de groupe A.

LIMITES

1. Le résultat positif est obtenu dans les 5 minutes.
2. Le résultat négatif est obtenu dans les 5 minutes.
3. Le test est stable pendant 15 minutes.
4. Le test est stable pendant 15 minutes.
5. Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE


Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

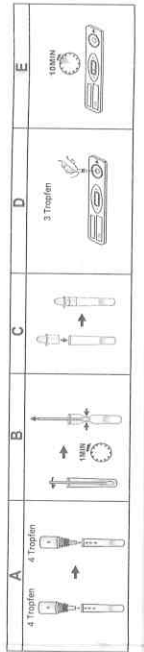

WIE IST DAS ERGEBNIS AUSZUWERTEN?

Le résultat positif est obtenu dans les 5 minutes. Le résultat négatif est obtenu dans les 5 minutes. Le test est effectué dans la zone de test (T) de la bandelette et la ligne de contrôle (C) est toujours présente. Si la ligne de test (T) est présente, le résultat est positif (P) et indique la présence de streptocoque de groupe A. Si la ligne de test (T) est absente, le résultat est négatif (N) et indique l'absence de streptocoque de groupe A.

LIMITES

1. Le résultat positif est obtenu dans les 5 minutes.
2. Le résultat négatif est obtenu dans les 5 minutes.
3. Le test est stable pendant 15 minutes.
4. Le test est stable pendant 15 minutes.
5. Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

STABILITE

Le test est stable pendant 15 minutes.

Beschriftung	Symbol	Bedeutung
REF	[Symbol]	Referenznummer
LOT	[Symbol]	Losnummer
Hersteller	[Symbol]	Hersteller

Hersteller	Produktname	Verwendbar bis	Temperaturbereich	Stabilität
Wondfo	Strept A Swab Test	...	4-30°C	15 Min.

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
 No.8 Lishihan Road, Science City, Luogang
 District, 510663, Guangzhou, P.R.China
 Tel: (+86) 400-830-8768
 E-mail: sales@wondfo.com.cn
 Website: en.wondfo.com.cn

CE IVD
 Q123
 Opalstraat 3
 2440 Geel
 Belgium